


(19)



Lietuvos
Respublikos
valstybinis
patentų biuras

(10)

LT 2017 526 A

(12) **PARAIŠKOS APRAŠYMAS**

(21) Paraiškos numeris: **2017 526** (51) Int. Cl. (2019.01): **G01N 27/00**

(22) Paraiškos padavimo data: **2017-09-21**

(41) Paraiškos paskelbimo data: **2019-03-25**

(62) Paraiškos, iš kurios dokumentas išskirtas, numeris: —

(86) Tarptautinės paraiškos numeris: —

(86) Tarptautinės paraiškos padavimo data: —

(85) Nacionalinio PCT lygio procedūros pradžios data: —

(30) Prioritetas: —

(71) Pareiškėjas:

Vilniaus Universitetas, Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, LT

(72) Išradėjas:

Arūnas RAMANAVIČIUS, LT

Aušra VALIŪNIENĖ, LT

Urtė SAMUKAITĖ-BUBNIENĖ, LT

Povilas VIRBICKAS, LT

Almira RAMANAVIČIENĖ, LT

(74) Patentinis patikėtinis/atstovas:

**Jurga PETNIŪNAITĖ, AAA Law, A. Goštauto g. 40B, Verslo centras „Dvyniai”,
LT-03163 Vilnius, LT**

(54) Pavadinimas:

**Berlyno mėlynojo pasluoksnio ant titanio pagrindo formavimo metodai ir jų
taikymas gliukozės biologiniuose jutikliuose**

(57) Referatas:

Šis išradimas aprašo biologinių jutiklių, kurie gali būti panaudojami gliukozės kiekio nustatymui mėginiuose, gamybos būdus. Šiuose biojutikliuose naudojamos titanio plokštelės padengtos Berlyno mėlynojo sluoksniu, prie kurio prijungiamas polipiroloinkaras arba tiesiogiai nusodinamas fermentas, leidžiantis aptikti mėginyje esančią analitę. Gaminant gliukozės biojutiklius, šis fermentas yra gliukozės oksidazė. Šie biojutikliai pranašesni tuo, kad jų veikimui naudojamas žemas elektrodo potencialas.

BERLYNO MĖLYNOJO PASLUOKSPIO ANT TITANO PAGRINDO FORMAVIMO METODIKOS IR TAIKYMAS GLIUKOZĖS BIOLOGINIUOSE JUTIKLIOSE

Išradimo sritis

Išradimas susijęs su Berlyno mėlynojo dengimo metodika ir šios metodikos panaudojimu nusodinant dangas ant titano pagrindo, siekiant suformuoti gliukozės biologinius jutiklius.

Technikos lygis

Biologiniai jutikliai apibūdinami kaip analizinės sistemos, sudarytos iš biologinio atpažinimo elemento, sujungto su signalo vertikliu, teikiančios analizinius duomenis, kurie yra proporcingi nustatomojo objekto koncentracijai (L. Su et al., 2011). Pagal naudojamą signalo vertiklį biologiniai jutikliai skirstomi į elektrocheminius, pjezoelektrinius, jonams selektyvius, optinius, magnetinius bei akustinius biojutiklius (R. Monošík et al., 2012). Biologiniuose jutikliuose naudojami įvairūs biologiniai atpažinimo elementai: antikūnai, īastelės, DNR, RNR, fermentai ir kitos struktūros (M. Park, 2013).

Fermentinių biologinių jutiklių (juose biologinio atpažinimo funkciją atlieka fermentas) veikimas pagrįstas fermento katalizuojama analitės chemine reakcija (A. Mulchandani, 1999).

Amperometriniai biologiniai jutikliai – tai elektrocheminiai biologiniai jutikliai, kurie atlieka elektros srovės, susijusios su analitės redokso reakcijomis, matavimus (A. Chaubey ir B.D. Malhotra, 2002). Amperometriniai fermentiniai biologiniai jutikliai yra skirstomi į 3 klasses (S.V. Dzyadevych et al., 2008):

1. Biologinius jutiklius, kuriuos naudojant vyksta tiesioginis fermentinės reakcijos produkto koncentracijos nustatymas.
2. Biologinius jutiklius, naudojančius elektronų pernašos tarpininką (EPT), pernešančią elektronus iš aktyvaus fermento centro į elektrodą.
3. Biologinius jutiklius, kuriuose tiesiogiai vyksta elektronų pernaša tarp fermento ir elektrodo.

Gliukozės koncentracijos kraujyje matavimas yra svarbiausias diagnostinis kriterijus, skirtas pacientų, sergančių cukriniu diabetu, stebėjimui. Efektyvi cukrino diabeto kontrolė priklauso nuo tikslios gliukozės koncentracijos kraujyje stebėjimo sistemos, kurioje gliukozės biologiniai jutikliai užimą vieną svarbiausių vietų.

Amperometriniai gliukozės biologiniai jutikliai gali priklausyti kiekvienai iš išvardintų amperometrinių biojutiklių klasių. Pirmos klasės gliukozės biologinių jutiklių veikimas pagrįstas vandenilio peroksono, susidarančio gliukozės oksidacijos metu, nustatymu (J. Wang, 2008).

Formuojant antros klasės gliukozės biologinius jutiklius naudojami elektronų pernašos tarpininkai (pvz.: ferocenas, fericianidas), leidžiantys sumažinti analizės metu naudojamą darbinio elektrodo potencialą (E.H. Yoo ir S.Y. Lee, 2010).

Trečios klasės amperometriniuose gliukozės biologiniuose jutikliuose naudojamos laidžios organinės medžiagos, pvz., polipirolas, užtikrinančios tiesioginę elektronų pernašą tarp elektrodo ir fermento (C. G. J. Koopal et al., 1994).

Berlyno mėlynasis yra vienas dažniausiai naudojamų elektrocheminių mediatorių analiziniam taikymui biologiniuose gliukozės jutikliuose (F. Ricci ir G. Palleschi, 2005). Biologiniai jutikliai registruojama vandenilio peroksono redukcijos srovė, todėl tyrimai orientuoti į vandenilio peroksidui atrankius elektrodus. Siekiant išvengti pašalinių medžiagų, esančių kraujyje (tokių kaip askorbo rūgštis, šlapimo rūgštis ir kt.), oksidacijos poveikio analizės rezultatams, darbiniam elektrodiui turi būti suteiktas santykinai žemas potencialas. Vienas iš būdų darbinio elektrodo potencialui sumažinti yra peroksidazių (pvz., krienų peroksidazės) naudojimas (T. Ruzgas et al., 1996) – naudojant peroksidazes, vandenilio peroksono redukcija vyksta esant žemesniems darbinio elektrodo potencialams (Z. Gao et al., 2014). Tačiau šis būdas turi ir trūkumų, tokių kaip didelės gamybinės išlaidos, žemas stabilumas, krienų peroksidazės ribotas nusodinimas ant kietų paviršių. Berlyno mėlynasis – tai vandenilio peroksono redukcijos reakcijos katalizatorius, pasižymintis dideliu selektyvumu bei efektyvumu vandenilio peroksono redukcijos reakcijos katalizei, todėl Berlyno mėlynasis kartais vadinas „dirbtine peroksidaze“ (A. A. Karyakin, 1999; Z. Gao et al., 2014). Taigi, gliukozės biologinių jutiklių, neturinčių vandenilio peroksono redukcijos katalizatorių, naudojimas turi trūkumų:

- 1) tiesioginis analičių amperometrinis nustatymas tradiciniuose elektroduose reikalauja santykinai aukšto potencialo, kuriam esant tirpale gali lengvai oksiduotis kitos medžiagos.
- 2) siekiant išvengti pašalinių medžiagų oksidacijos srovių įtakos matavimų rezultatams, naudojami papildomi apsauginiai sluoksniai (pvz., celiuliozės-acetatinės membranos, nafiono danga, sintetiniai polimerai), tačiau dangos ne pilnai apsaugo nuo nepageidaujamų jonų ar molekulių, pvz., askorbo, šlapimo rūgščių, prasiskverbimo (A. Ambrozy et al., 2013), prailgina biojutiklio atsako laiką (M.S. Alaejos ir J.G. Montelongo, 2004) taip pat turi būti suteiktas santykinai aukštas darbinis potencialas.

Nafiono danga apsaugo biojutiklį nuo anijoninių elektrochemiškai aktyvių medžiagų patekimo prie biojutiklio paviršiaus – šios medžiagos nėra oksiduojamos biojutiklio paviršiuje ir todėl nedaro įtakos matavimų rezultatams (S.H. Lim, 2005; L. Yang, 2009). Nepaisant to, kad nafiono danga apsaugo matavimo rezultatus nuo analizės tikslumui įtaką darančių oksidacijos srovių (sukeliamų pašalinių medžiagų oksidacijos biojutiklio paviršiuje), naudojant nafiono dangą biojutikliui turi būti suteikiamas santykinai aukštas darbinis potencialas, nors yra žinoma, kad žemas darbinis potencialas, palaikomas analizės metu, daro teigiamą įtaką ląstelių proliferacijai (A. Vaitkuvienė et al., 2013). Siekiant sumažinti biojutiklio darbinį potencialą ir taip išvengti pašalinių elektrochemiškai aktyvių medžiagų oksidacijos, kaip vienas iš variantų, grafito elektrodas, modifikuotas polipirolu, Berlyno mėlynuoju ir gliukozės oksidazės kompozitiniu sluoksniu, neseniai buvo aprašytas A. Ramanavičiaus ir kitų bendraautorių (A. Ramanavičius, 2017).

Pastaruoju metu didelį susidomėjimą šioje srityje sukélé neorganiniai vandenilio peroksido redukcijos reakcijos katalizatoriai, tame tarpe – elektrokataliziniai pereinamujų metalų heksacianoferatiniai kompleksai, ypatingai Berlyno mėlynasis, kuris pirmą kartą kaip „dirbtinė peroksidazė“ biojutiklyje gliukozės nustatymui buvo panaudotas 1995 metais Karyakin (A.A. Karyakin, 2001). Ant Berlyno mėlynojo paviršiaus gali vykti molekulinio deguonies ir vandenilio peroksido redukcija. Vandenilio peroksido redukcijos reakcija gali būti katalizuojama Berlyno mėlynuoju (K. Itaya et al., 1984). Kiti neorganiniai vandenilio peroksido redukcijos reakcijos katalizatoriai, ne tik tarp heksacianoferatinių kompleksų, bet ir tarp kitų žinomų H_2O_2 redukcijos mediatorių, nepasižymi tokiu efektyvumu, kaip Berlyno mėlynasis. H_2O_2 redukcijos srovė, matuojama naudojant Berlyno mėlynuoju modifikuotą elektrodą, dukart didesnė nei O_2 redukcijos srovė, tuo tarpu platina ar kiti taurieji metalai nepasižymi selektyvumu vandenilio peroksido redukcijai esant molekuliniams deguoniui (A.A. Karyakin et al., 2001; A.A. Karyakin et al., 1998; A.A. Karyakin and E.E. Karyakina, 1999).

Formuojant gliukozės biojutiklius svarbu parinkti substratą, tinkamą elektrochemiškai aktyvaus sluoksnio formavimui. Substratas turi pasižymeti aukštu elektrocheminiu aktyvumu, taip pat cheminiu bei mechaniniu stabilumu. Pastaruoju metu titano oksidas plačiai naudojamas gliukozės biojutiklių kūrime. Titanas pasižymi biosuderinamumu, atsparumu korozijai bei žema kaina (lyginant titaną su kitomis medžiagomis, naudojamomis substratu formuojant gliukozės biojutiklius, pvz.: auksu ir platina). Be minėtų naudingų titano savybių, titanas pasižymi ir tinkamumu būti modifikuojamam Berlyno mėlynojo danga, padengiama atliekant cheminių arba elektrocheminių nusodinimų.

Kai kurių gliukozės biojutiklių formavimo metu, Berlyno mėlynojo danga buvo padengta ant titano

oksidu nanodalelių ar titano oksido zolio-gelio pavidalo junginių, skirtinį elektrodo medžiagą (SnO_2 , platinos, aukso, stiklo, anglies ir kt.). Tačiau šie dengimo metodai turi ir trūkumų:

- 1) TiO_2 nanodalelių ar zolių-gelių sintezė pati savaime yra brangi procedūra.
- 2) Titano oksido nanodalelių sintezės procesai yra daugiapakopiai ir sudėtingi, todėl metalurginio Ti panaudojimas keliais žingsniais supaprastina ir atpiga procesą.

Vienas iš fermentų imobilizavimo biojutikliuose metodų yra imobilizacija, atliekama panaudojant elektrai laidžius polimerus – šie polimerai gali būti naudojami kaip terpė, skirta kovalentiniams fermentų prijungimui arba jų adsorbavimui. Biomolekulių imobilizavimas, atliekamas naudojantis elektrai laidžiais polimerais (pvz., polipirolu), taip pat palengvina elektrono pernašą nuo fermento į elektrodą. Šiame išradime gliukozės oksidazės imobilizavimui buvo panaudotas polipirolo pasluoksnis.

Trumpas išradimo aprašymas

Išradime pateikta Berlyno mėlynojo nusodinimo ant titano pagrindo metodika, kuri apima cheminj bei elektrocheminj Berlyno mėlynojo nusodinimo ant titano metalurginės plokštelės būdą. Šioje metodikoje taip pat panaudojamos polipirolo pasluoksnio nusodinimo bei gliukozės oksidazės imobilizavimo procedūros, atliekamos siekiant suformuoti gliukozės biojutiklius.

Darbo metu pagaminti tokio tipo biojutikliai:

1. Biojutiklis, suformuotas padengiant titano elektrodą Berlyno mėlynojo pasluoksniu elektrochemiškai ir elektrocheminio polipirolo nusodinimo metu imobilizuojant gliukozės oksidazę.
2. Biojutiklis, suformuotas padengiant titano elektrodą Berlyno mėlynojo pasluoksniu elektrochemiškai, iškaitinančia Berlyno mėlynojo pasluoksnį krosnyje ir elektrocheminio polipirolo nusodinimo metu imobilizuojant gliukozės oksidazę.
3. Biojutiklis, suformuotas padengiant titano elektrodą Berlyno mėlynojo pasluoksniu elektrochemiškai, ant jo elektrochemiškai nusodinant polipirolo dangą bei imobilizuojant gliukozės oksidazę naudojantis gliutaro aldehido garais.
4. Biojutiklis, suformuotas ant titano plokštelės chemiškai nusodinant Berlyno mėlynojo pasluoksnį ir imobilizuojant gliukozės oksidazę su gliutaro aldehido garais.

5. Biojutiklis, suformuotas ant titano plokštelės chemiškai nusodinant Berlyno mėlynojo pasluoksnį, iškaitinančią kaitinimo krosnyje ir imobilizuojant gliukozės oksidazę su gliutaro aldehydo garais.
6. Biojutiklis, suformuotas ant titano plokštelės chemiškai padengiant Berlyno mėlynojo pasluoksnį, iškaitinančią krosnyje ir imobilizuojant gliukozės oksidazę elektrocheminės polipirolo polimerizacijos metu.
7. Biojutiklis, suformuotas padengiant Berlyno mėlynojo pasluoksnį elektrochemiškai, iškaitinančią pasluoksnį krosnyje ir imobilizuojant gliukozės oksidazę su gliutaro aldehydo garais.

Detalus išradimo aprašymas

Medžiagos ir metodai

Fermentas - gliukozės oksidazė (GO) (360 U mg^{-1}), gliukozė, $\text{FeCl}_3 \times 6 \text{ H}_2\text{O}$, NaCl , NaH_2PO_4 ir $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ buvo įsigytos iš „ROTH“ įmonės. Pirolas įsigytas iš „Alfa Aesar“ įmonės. Darbo metu paruoštų tirpalų gamybai buvo naudojamas ultrafiltracinis vanduo.

Darbo metu atliktoms elektrocheminio matavimo ir elektrocheminio nusodinimo procedūroms buvo naudojamas prie kompiuterio prijungtas $\mu\text{AUTOLAB}$ potencijostatas/galvanostatas su instaliuota programine įranga GPES. Elektrocheminiai procesai buvo vykdomi trijų elektrodų celėje, kurioje darbiniu elektrodu naudota titano plokštelė (paviršiaus plotas 1 cm^2), palyginamuju – $\text{Ag}/\text{AgCl}/\text{KCl}_{(\text{sotus})}$ elektrodas, pagalbiniu – titano plokštelė.

Elektrocheminis Berlyno mėlynojo (BM), polipirolo (PP) ir kompozicinio BM/PP/GO sluoksniu nusodinimas bei chronoamperometriniai biojutiklių tyrimai atlikti naudojantis $\mu\text{AUTOLAB}$ potencijostatu/galvanostatu, įsigytu iš ECO-Chemie įmonės (Utrechtas, Olandija). Elektrocheminiai procesai buvo vykdomi trijų elektrodų celėje, kurioje darbiniu elektrodu naudota titano plokštelė (paviršiaus plotas 1 cm^2), palyginamuju – $\text{Ag}/\text{AgCl}/\text{KCl}_{(\text{sotus})}$ elektrodas, pagalbiniu – titano plokštelė. Chronoamperometrinį matavimą metu darbiniam elektrodiui suteiktas $0,05 \text{ V}$ potencialas $\text{Ag}/\text{AgCl}/\text{KCl}_{(\text{sotus})}$ elektrodo atžvilgiu. Matavimai buvo atliekami pH 7,3 buferiniame tirpale, sudarytame iš $0,1 \text{ M NaCl}$ ir $0,01 \text{ M NaH}_2\text{PO}_4$. Prieš jlašinant gliukozės į buferinį tirpalą, buvo laukiama, kol nusistovės pastovi srovė elektrocheminėje celėje. Tuomet į buferinį tirpalą buvo jlašinama 1 M gliukozės tirpalo bei įjungiamas maišymas (magnetinė maišykla), kad gliukozės koncentracija visame tirpalo tūryje būtų vienoda. Po $1 - 2 \text{ min}$. maišymas buvo išjungiamas, po maišymo išjungimo nusistovėdavo pastovi elektros srovė, kuri

buvo regiszruojama. Tyrimų metu matuotas elektros srovės pokytis (atsiradęs po gliukozės įlašinimo į buferinį tirpalą), kuris yra proporcings gliukozės koncentracijai tirpale.

Brėžinių aprašymas

1a paveikslas. Biojutikliu, suformuotu padengiant Ti elektrodą Berlyno mėlynojo pasluoksniu elektrochemiškai (atliekant 40 voltamperometrinių ciklų), vėliau ant jo polipirolo elektrocheminio nusodinimo metu imobilizuojant gliukozės oksidazę, srovės tankio priklausomybės nuo gliukozės koncentracijos tirpale kreivės.

1b paveikslas. Biojutikliu, suformuotu padengiant Ti elektrodą Berlyno mėlynojo pasluoksniu elektrochemiškai (atliekant 50 voltamperometrinių ciklų), vėliau ant jo polipirolo elektrocheminio nusodinimo metu imobilizuojant gliukozės oksidazę, srovės tankio priklausomybės nuo gliukozės koncentracijos tirpale kreivės.

2 paveikslas. Biojutikliu, suformuotu padengiant Ti elektrodą Berlyno mėlynojo pasluoksniu elektrochemiškai, iškaitinant Berlyno mėlynojo pasluoksnį krosnyje ir elektrocheminio polipirolo nusodinimo metu imobilizuojant gliukozės oksidazę, srovės tankio priklausomybės nuo gliukozės koncentracijos tirpale kreivės.

3 paveikslas. Biojutikliu, suformuotu padengiant Ti elektrodą Berlyno mėlynojo pasluoksniu elektrochemiškai, ant jo elektrochemiškai nusodinant polipirolo dangą bei imobilizuojant gliukozės oksidazę naudojantis gliutaro aldehydo garais, srovės tankio priklausomybės nuo gliukozės koncentracijos tirpale kreivės.

4 paveikslas. Biojutikliu, suformuotu ant Ti plokštelių chemiškai nusodinant Berlyno mėlyno pasluoksnį ir imobilizuojant gliukozės oksidazę su gliutaro aldehydo garais, srovės tankio priklausomybės nuo gliukozės koncentracijos tirpale kreivės.

5 paveikslas. Biojutikliu, suformuotu ant Ti plokštelių chemiškai nusodinant Berlyno mėlyno pasluoksnį, iškaitinant jį kaitinimo krosnyje ir imobilizuojant gliukozės oksidazę su gliutaro aldehydo garais, srovės tankio priklausomybės nuo gliukozės koncentracijos tirpale kreivės.

6 paveikslas. Biojutikliu, suformuotu ant Ti plokštelių chemiškai nusodinant Berlyno mėlyno pasluoksnį, iškaitinant jį kaitinimo krosnyje ir imobilizuojant gliukozės oksidazę elektrocheminės polipirolo polimerizacijos metu, srovės tankio priklausomybės nuo gliukozės koncentracijos tirpale kreivės.

7 paveikslas. Biojutikliu, suformuotu padengiant Ti elektrodą Berlyno mėlyno pasluoksniu elektrochemiškai, iškaitinant Berlyno mėlynojo pasluoksnį krosnyje ir su gliutaro aldehido garais imobilizuojant gliukozės oksidazę, srovės tankio priklausomybės nuo koncentracijos tirpale kreivės.

8 paveikslas. Visų aštuonais skirtingais būdais (išskaitant 1a ir 1b) pagamintų biojutiklių palyginimas. Visi biojutikliai buvo tiriami pagaminimo dieną.

Detali eiga

Gaminant gliukozės biojutiklį pirmiausia ant titano plokštelės buvo padengiamas Berlyno mėlynojo (BM) pasluoksnis. Tai buvo atliekama:

- a) elektrochemiškai nusodinant Berlyno mėlynojo sluoksnį ant titano plokštelės ciklinės voltamperometrijos būdu, skleidžiant potencialą nuo 0,4 V iki 0,8 V(Ag/AgCl/KCl_(sotus) atžvilgiu) 1 mM FeCl₃ ir K₃[Fe(CN)₆] tirpale
- b) chemiškai nusodinant Berlyno mėlynaji, laikant titano plokštelę 1 mM FeCl₃ ir K₃[Fe(CN)₆] tirpale
- c) Berlyno mėlynojo pasluoksnis buvo iškaitinamas krosnyje 1 val. 100 °C arba naudojamas be iškaitinimo
- d) ant Berlyno mėlynojo pagrindo elektrochemiškai dengiamas polipirolo sluoksnis, po to imobilizuojamas fermentas - gliukozės oksidazė.

Gliukozės oksidazės imobilizacija atlikta:

- a) elektrochemiškai nusodinant polipirolą pirolo (30 mM), FeCl₃(1 mM), K₃[Fe(CN)₆] (1 mM) bei gliukozės oksidazės (1 mg ml⁻¹) mišinyje skleidžiant potencialą nuo 0,4 iki 0,8 V (Ag/AgCl/KCl_(sotus) atžvilgiu) ciklinės voltamperometrijos būdu
- b) užlašinant ant elektrodo, padengto Berlyno mėlynojo pasluoksniu, 40 mg ml⁻¹gliukozės oksidazės tirpalo (pagaminto ph 7,3 fosfatiname buferyje), ji išdžiovinant ore bei laikant virš gliutaro aldehido 25 % tirpalo 15 min.

Ciklinės voltamperometrijos metu pagalbiniu elektrodu buvo naudojama titano plokštelė, palyginamuoju – Ag/AgCl (KCl_(konc.)) elektrodas.

Amperometrinį tyrimų metu darbiniam elektrodiui buvo suteiktas 0,05 V potencialas Ag/AgCl/KCl_(sotus) elektrodo atžvilgiu. Pagalbiniu elektrodu naudota Ti plokštelė.

Gaminant skirtingus biojutiklius, buvo pastebėta, kad biojutikliai, suformuoti imobilizuojant fermentą - gliukozés oksidazę - su gliutaro aldehydo garais bei cheminiu būdu padengiant Berlyno mėlynojo pasluoksnį, analizės metu pasižymi didesniu srovės tankiu (siekė iki $33,9 \mu\text{A}\cdot\text{cm}^{-2}$), gaunamu po gliukozés įlašinimo į analizuojamą tirpalą, nei biojutikliai, suformuoti elektrochemiškai padengiant Berlyno mėlynojo pasluoksnį bei elektrocheminės pirolo polimerizacijos metu imobilizuojant gliukozés oksidazę (jų generuojamas srovės tankis siekė iki $23,8 \mu\text{A}\cdot\text{cm}^{-2}$).

Iškaitinus Berlyno mėlynojo pasluoksnį, padidėja tyrimo metu biojutiklio generuojamos srovės tankis: tiriant biojutiklius, suformuotus padengiant titano elektrodą Berlyno mėlyno pasluoksniu elektrochemiškai ir elektrocheminio polipirolo nusodinimo metu imobilizuojant gliukozés oksidazę, didžiausias registruotas srovės tankis buvo $12 \mu\text{A}\cdot\text{cm}^{-2}$, o tiriant biojutiklius, suformuotus padengiant titano elektrodą Berlyno mėlyno pasluoksniu elektrochemiškai, iškaitinant Berlyno mėlynojo pasluoksnį krosnyje ir elektrocheminio polipirolo nusodinimo metu imobilizuojant gliukozés oksidazę, didžiausias tyrimų metu registruotas srovės tankis buvo $23,8 \mu\text{A}\cdot\text{cm}^{-2}$.

Tiriant biojutiklius, suformuotus padengiant titano plokštelię Berlyno mėlynuoju chemiškai, iškaitinančius dangą ir imobilizuojant gliukozés oksidazę elektrocheminio polipirolo nusodinimo metu, buvo pastebėta, kad gliukozés mėginio analizės metu šio tipo biojutiklių generuojama srovė pasiekė dideles vertes – viršijo $40 \mu\text{A}/\text{cm}^2$. Šio tipo biojutikliams būdingas ir platus nustatomos gliukozés koncentracijos intervalas – elektros srovės stipris dažniausiai ženkliai didėjo po gliukozés koncentracijos padidėjimo mėginyje tol, kol gliukozés koncentracija pasiekdavo 100 mM .

Tiriant biojutiklius, suformuotus padengiant titano plokštelię Berlyno mėlynuoju elektrochemiškai, iškaitinančius dangą ir imobilizuojant gliukozés oksidazę su gliutaro aldehydo garais, buvo pastebėta, kad gliukozés mėginio analizės metu šio tipo biojutiklių generuojama srovė dažniausiai neviršydavo $-15 \mu\text{A}/\text{cm}^2$. Šio tipo biojutikliams būdingas siauras nustatomos gliukozés koncentracijos intervalas – elektros srovės stipris dažniausiai ženkliai didėjo po gliukozés koncentracijos padidėjimo mėginyje tol, kol gliukozés koncentracija pasiekdavo 6 mM . Taip pat šio tipo biojutikliams būdingas stabilumas laike – tiriant gliukozés mėginį šio tipo biojutikliais, praėjus savaitei po biojutiklio pagaminimo, generuojamos srovės stipris dažnai būdavo neženkliai mažesnis ar didesnis nei atliekant tyrimą biojutiklio pagaminimo dieną.

Apibendrinant galima teigti, kad biojutikliai, suformuoti padengiant titano elektrodą Berlyno mėlyno pasluoksniu elektrochemiškai, iškaitinančius Berlyno mėlynojo pasluoksnį krosnyje ir

elektrocheminio polipirolo nusodinimo metu imobilizuojant gliukozés oksidazę pasižymi geriausiomis savybėmis.

Jautriausi gliukozés biojutikliai suformuoti naudojant cheminį Berlyno mėlynojo nusodinimą ir gauto pasluoksnio iškaitinimą.

Biojutikliai, suformuoti elektrochemiškai padengiant Berlyno mėlynojo pasluoksnį, iškaitinančią ir chemiškai imobilizuojant gliukozés oksidazę, buvo stabiliausi.

Išradimo įgyvendinimo pavyzdžiai

Žemiau yra pateikti išradimo gamybos pavyzdžiai. Išradimas nėra ribojamas šiais pavyzdžiais.

1 pavyzdys. Biojutiklis, suformuotas padengiant titano elektrodą Berlyno mėlyno pasluoksniu elektrochemiškai ir elektrocheminio polipirolo nusodinimo metu imobilizuojant gliukozés oksidazę (1) buvo paruoštas taip: Berlyno mėlyno pasluoksnis buvo nusodintas ant titanio plokštelių ciklinės voltamerometrijos būdu, skleidžiant potencialą nuo 0,4 V iki 0,8 V 1 mM FeCl_3 ir $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ tirpale 40 ciklų (1a pav.) arba 50 ciklų (1b pav.). Vėliau ant elektrodo buvo imobilizuojama gliukozés oksidazė – tai buvo atliekama elektrochemiškai nusodinant polipirolą pirolo (30 mM), gliukozés oksidazės (1 mg ml^{-1}) bei 1 mM FeCl_3 ir $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ tirpale ciklinės voltamerometrijos būdu, skleidžiant potencialą nuo 0,4 V iki 0,8 V 20 ciklų. Šiuo biojutikliu išmatuotos elektros tankio priklausomybės nuo gliukozés koncentracijos tirpale kreivės pateiktos 1a pav. ir 1b pav.

2 pavyzdys (1-as + BM kaitinimas). Biojutiklis, suformuotas padengiant Ti elektrodą Berlyno mėlynojo pasluoksniu elektrochemiškai, iškaitinančią Berlyno mėlynojo pasluoksnį krosnyje ir polipirolo elektrocheminio nusodinimo metu imobilizuojant gliukozés oksidazę (2 pav.) buvo ruošiamas nusodinant Berlyno mėlyno pasluoksnį ant titanio plokštelių ciklinės voltamerometrijos būdu, skleidžiant potencialą nuo 0,4 V iki 0,8 V 1 mM FeCl_3 ir $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ tirpale 40 ciklų. Po to Berlyno mėlyno pasluoksniu padengtas Ti buvo iškaitintas 100 °C temperatūros kaitinimo krosnyje 1 val., atvésintas iki kambario temperatūros, nuplautas miliporiniu vandeniu ir išdžiovintas ore. Ant išdžiovinto elektrodo buvo imobilizuojama gliukozés oksidazė – tai buvo atliekama elektrochemiškai nusodinant polipirolą pirolo (30 mM), gliukozés oksidazės (1 mg ml^{-1}) bei 1 mM FeCl_3 ir $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ tirpale ciklinės voltamerometrijos būdu, skleidžiant potencialą nuo 0,4 V iki 0,8 V 20 ciklų. Šiuo biojutikliu išmatuotos srovės tankio priklausomybės nuo gliukozés koncentracijos tirpale kreivės pateiktos 2 pav.

3 pavyzdys. Biojutiklis, suformuotas padengiant titano elektrodą Berlyno mėlynojo pasluoksniu elektrochemiškai, ant jo elektrochemiškai nusodinant polipirolo dangą bei imobilizuojant gliukozés oksidazę naudojantis gliutaro aldehydo tirpalu (3 pav.) buvo ruošiamas taip: Berlyno mėlynojo pasluoksnis buvo nusodintas ant Ti plokštelės ciklinės voltamperometrijos būdu, skleidžiant potencialą nuo 0,4 V iki 0,8 V 1 mM FeCl_3 ir $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ tirpale 40 ciklų. Nusodinus Berlyno mėlynojo dangą ant jos buvo nusodinta polipirolo danga. Tai buvo atlikta ciklinant elektrodą pirolo mišinyje (sudarytame iš pirolo (30 mM) ir FeCl_3 (1 mM) bei $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ (1 mM)) 20 ciklų skleidžiant potencialą nuo 0,4 V iki 0,8 V. Gautas elektrodas buvo nuplautas miliporiniu vandeniu, išdžiovintas ore. Po to ant elektrodo buvo lašinamas gliukozés oksidazés tirpalas (40 mg ml^{-1} gliukozés oksidazés tirpalas pH 7,3 fosfatiname buferyje), drėgnas elektrodas išdžiovintas ore ir įfiksotas virš gliutaro aldehydo (25 %) tirpalo, laikytas virš jo 15 min. Šiuo biojutikliu išmatuotos srovės tankio priklausomybės nuo gliukozés koncentracijos tirpale kreivės pateiktos 3 pav.

4 pavyzdys. Biojutiklis, suformuotas ant titano plokštelės chemiškai nusodinant Berlyno mėlynojo pasluoksnį ir imobilizuojant gliukozés oksidazę su gliutaro aldehydo garais (4 pav.) buvo paruoštas įmerkiant Ti plokštelę į 1 mM FeCl_3 ir $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ mišinį, laikant plokštelę mišinyje 60 min., ištraukiant, nuplaunant miliporiniu vandeniu ir išdžiovinant ore. Gliukozés oksidazė imobilizuota užlašinant gliukozés oksidazés tirpalo (40 mg ml^{-1} gliukozés oksidazés tirpalas pH 7,3 fosfatiname buferyje), išdžiovinant drėgną elektrodą ore ir įfiksujant virš gliutaro aldehydo (25 %) tirpalo, laikant virš jo 15 min. Biojutikliu išmatuotos srovės tankio priklausomybės nuo gliukozés koncentracijos tirpale kreivės pateiktos 4 pav.

5 pavyzdys (4-tas + BM iškaitinimas). Biojutiklis, suformuotas ant Ti plokštelės chemiškai nusodinant Berlyno mėlynojo pasluoksnį, iškaitinančią kaitinimo krosnyje ir imobilizuojant gliukozés oksidazę su gliutaro aldehydo garais (5 pav.) buvo paruoštas įmerkiant Ti plokštelę į 1 mM FeCl_3 ir $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ mišinį, laikant plokštelę mišinyje 40 min. Po to Berlyno mėlynojo pasluoksniu padengtas Ti buvo iškaitintas 100 °C temperatūros kaitinimo krosnyje 1 val., atvésintas iki kambario temperatūros, nuplautas miliporiniu vandeniu ir išdžiovintas ore. Gliukozés oksidazė imobilizuota užlašinant gliukozés oksidazés tirpalo (40 mg ml^{-1} gliukozés oksidazés tirpalas pH 7,3 fosfatiname buferyje), išdžiovinant drėgną elektrodą ore ir įfiksujant virš gliutaro aldehydo (25 %) tirpalo, laikant virš jo 15 min. Šiuo biojutikliu išmatuotos srovės tankio priklausomybės nuo gliukozés koncentracijos tirpale kreivės pateiktos 5 pav.

6 pavyzdys. Biojutiklis, suformuotas ant Ti plokštelės chemiškai nusodinant Berlyno mėlyno pasluoksnį, iškaitinančią kaitinimo krosnyje ir imobilizuojant gliukozés oksidazę polipirolo

elektrocheminio nusodinimo metu (6) buvo paruoštas jmerkiant titano plokštelę į 1 mM FeCl_3 ir $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ mišinį, laikant plokštelę mišinyje 40 min. Po to Berlyno mėlyno pasluoksniu padengtas Ti buvo iškaitintas 100 °C temperatūros kaitinimo krosnyje 1 val., atvésintas iki kambario temperatūros, nuplautas miliporiniu vandeniu ir išdžiovintas ore. Ant išdžiovinto elektrodo buvo imobilizuojama gliukozės oksidazė – tai buvo atliekama elektrochemiškai nusodinant polipirolą pirolo (30 mM), gliukozės oksidazės (1 mg ml^{-1}) bei 1 mM FeCl_3 ir $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ tirpale ciklinės voltamerometrijos būdu, skleidžiant potencialą nuo 0,4 V iki 0,8 V 20 ciklų. Šiuo biojutikliu išmatuotos srovės tankio priklausomybės nuo gliukozės koncentracijos tirpale kreivės pateiktos 6 pav.

7 pavyzdys. Biojutiklis, suformuotas padengiant Ti elektrodą Berlyno mėlynojo pasluoksniu elektrochemiškai, iškaitinant Berlyno mėlynojo pasluoksnį krosnyje ir su gliutaro aldehydo garais imobilizuojant gliukozės oksidazę (7 pav.), buvo ruošiamas nusodinant Berlyno mėlynojo pasluoksnį ant Ti plokštelės ciklinės voltamperometrijos būdu, skleidžiant potencialą nuo 0,4 V iki 0,8 V 1 mM FeCl_3 ir $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ tirpale 40 ciklų. Po to Berlyno mėlynojo pasluoksniu padengtas Ti buvo iškaitintas 100 °C temperatūros kaitinimo krosnyje 1 val., atvésintas iki kambario temperatūros, nuplautas miliporiniu vandeniu ir išdžiovintas ore. Gliukozės oksidazė imobilizuota užlašinant gliukozės oksidazės tirpalą (40 mg ml^{-1} gliukozės oksidazės tirpalas pH 7,3 fosfatiniaiame buferyje), išdžiovinant drėgną elektrodą ore ir įfiksujant virš gliutaro aldehydo (25 %) tirpalą, laikant virš jo 15 min. Šiuo biojutikliu išmatuotos srovės tankio priklausomybės nuo gliukozės koncentracijos tirpale kreivės pateiktos 7 pav.


Literatūra

1. Alaejos M.S. and Montelongo J.G. Application of Amperometric Biosensors to the Determination of Vitamins and r-Amino Acids. *Chem. Rev.* 104, 2004, p. 3239-3265.
2. Amrozy A., Hlavata L., Labuda J. Protective membranes at electrochemical biosensors. *Acta Chimica Slovaca* 6 (2013), p. 35-41.
3. Chaubey A., Malhotra B.D. Mediated biosensors. *Biosensors and Bioelectronics*, 17 (6 - 7), 2002, p. 441 – 456.
4. Dzyadevych S.V., Arkhypova V.N., Soldatkin A.P., El'skaya A.V., Martelet C., Jaffrezic-Renault N. Amperometric enzyme biosensors: Past, present and future. *IRBM*, 29 (2 – 3), 2008, p. 171 – 180.
5. Gao Z., Qu Y., Li T., Shrestha N.K., Song Y. Development of Amperometric Glucose Biosensor Based on Prussian Blue Functionlized TiO₂ Nanotube Arrays. *Scientific Reports* 4, 2014, 6891.
6. Yang L., Ren X., Tang F., Zhang L. A practical glucose biosensor based on Fe₃O₄ nanoparticles and chitosan/nafion composite film. *Biosensors and Bioelectronics* 25 (4), 2009, p. 889 – 895.
7. Yoo E.H., Lee S.Y. Glucose Biosensors: An Overview of Use in Clinical Practice. *Sensors*, 10(5), 2010, p. 4558 – 4576.
8. Itaya K., Shoji N., Uchida I. Catalysis of the reduction of molecular oxygen to water at Prussian Blue modified electrodes. *J. Am. Chem. Soc.* 106, 1984, 3423- 3429.
9. Karyakin A.A., Karyakina E.E. Prussian Blue-based 'artificial peroxidase' as a transducer for hydrogen peroxidase detection. Application to biosensors, sensors and Actuators B 57, 1999, p. 268-273.
10. Karyakin, A.A. Prussian Blue and Its Analogues: Electrochemistry and Analytical Applications. *Electroanalysis* 13, 2001, p. 813-819.
11. Karyakin, A.A., Karyakina, E.E., Gorton, L. The electrocatalytic activity of Prussian blue in hydrogen peroxidase reduction studied using a wall-jet electrode with continuous flow. *Electroanalytical Chemistry* 456, 1998, p. 97-104.
12. Koopal C.G.J., Bos A.A.C.M., Nolte R.J.M. Third-generation glucose biosensor incorporated in a conducting printing ink. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 18 (1 – 3), 1994, p. 166 – 170.
13. Lim S.H., Wei J., Lin J., Li Q., Kua You J. A glucose biosensor based on electrodeposition of palladium nanoparticles and glucose oxidase onto Nafion-solubilized carbon nanotube electrode. *Biosensors and Bioelectronics* 20 (11), 2005, p. 2341 – 2346.
14. Mei S., Wang H., Wang W., Tong L., Pan H., Ruan C., Ma Q., Liu M., Yang H., Zhang L., Cheng Y., Zhang Y., Zhao L., Chu P.K. Antibacterial effects and biocompatibility of titanium surfaces with graded silver incorporation in titania nanotubes. *Biomaterials* 35, 2014, 4255-4265.
15. Monošík R., Stredanský M., Šturdík E. Biosensors — classification, characterization and new trends. *Acta Chimica Slovenica*, 5 (1), 2012, p. 109 – 120.
16. Mulchandani A. Principles of Enzyme Biosensors. *Enzyme and Microbial Biosensors*, 6, 1999, p. 3 – 14.
17. Park M., Tsai S. L., Chen W. Microbial Biosensors: Engineered Microorganisms as the Sensing Machinery. *Sensors*, 13 (5), 2013, p. 5777 – 5795.
18. Qian J., Liu Y., Liu H. et al. Characterization of regenerated silk fibroin membrane for immobilisation of peroxidase and construction of an amperometric hydrogen peroxide sensor employing phenazinemethosulphate as electron shuttle. *J ElectroanalChem* 1995; 397:157-162.
19. Ramanavicius A., Rekertaitė A.I., Valiūnas R., Valiūnienė A. Single-step procedure for the modification of graphite electrode by composite layer based on polypyrrole, Prussian blue and glucose oxidase. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 240, 2017, p. 220 – 230.


20. Ruzgas T., Csoregi E., Emneus J., Gorton L., Marko-Varga G. Peroxidase-modified electrodes: Fundamentals and application. *AnalyticaChimicaActa*, 1996, 123-138.
21. Su L., Jia W., Hou C., Lei Y. Microbial biosensors: A review. *Biosensors and Bioelectronics*, 26 (5), 2011, p. 1788 – 1799.
22. Vaitkuviene A., Kaseta V., Voronovic J., Ramanauskaitė G., Biziuleviciene G., Ramanaviciene A., Ramanavicius A. Evaluation of cytotoxicity of polypyrrole nanoparticles synthesized by oxidative polymerization. *Journal of Hazardous Materials*, 250 –251, 2013, p. 167 – 174.
23. Wang J. Electrochemical Glucose Biosensors. *Chemical Reviews*, 108 (2), 2008, p. 814 – 825.
24. Zhang M., Yuan R., Chai Y., Li W., Zhong H., Wang C. Glucose biosensor based on titanium dioxide-multiwall carbon nanotubes-chitosan composite and functionalized gold nanoparticles. *Bioprocess and Biosystems Engineering* 34, 2011, p. 1143 – 1150.

Išradimo apibrėžtis


1. Biojutiklio pagrindo, skirto elektronų pernašai ir medžiagų imobilizacijai, gamybos būdas, besiskiriantis tuo, kad apima Berlyno mėlynojo pasluoksnio padengimą ant titano plokštelių.
2. Biojutiklio pagrindo pagal 1 punktą gamybos būdas, kur padengimas yra atliekamas cheminiu būdu.
3. Biojutiklio pagrindo pagal 1 punktą gamybos būdas, kur padengimas yra atliekamas elektrocheminiu būdu skleidžiant žemą elektrinį potencialą.
4. Biojutiklio pagrindas gautas būdu pagal 2 punktą.
5. Biojutiklio pagrindas gautas būdu pagal 3 punktą.
6. Biojutiklio pagrindas pagal 4 arba 5 punktą, kur minėtas pagrindas yra kaitinamas krosnyje.
7. Biojutiklio gamybos būdas, kur ant pagrindo, pagal bet kurį vieną iš 4 - 6 punktų, yra nusodinamas fermentas, skirtas medžiagų kieko nustatymui mėginyje.
8. Biojutiklio gamybos būdas, pagal 7 punktą, kur prieš fermento, skirto medžiagų kieko nustatymui mėginyje, nusodinimą, ant Berlyno mėlynojo pasluoksnio, elektrocheminio nusodinimo būdu, yra nusodinamas polipirolas.
9. Biojutiklio gamybos būdas, pagal 7 arba 8 punktą, kur ant pagrindo skirtas nusodinti fermentas yra gliukozės fermentas.
10. Gliukozės biojutiklio pagal 9 punktą gamybos būdas, kur gliukozės oksidazės imobilizavimas yra atliekamas cheminiu arba elektrocheminiu būdu.
11. Gliukozės biojutiklio pagal 10 punktą gamybos būdas, kur gliukozės oksidazės cheminis imobilizavimas yra atliekamas gliutaro aldehydo garais.
12. Gliukozės biojutiklis pagal bet kurį vieną iš 9 - 11 punktų, kur jį naudojant yra naudojamas žemos elektrodo potencialas.
13. Biojutiklis, gautas būdu pagal 7 arba 8 punktą.
14. Gliukozės biojutiklis, gautas būdu pagal bet kurį vieną iš 9 - 12 punktų.

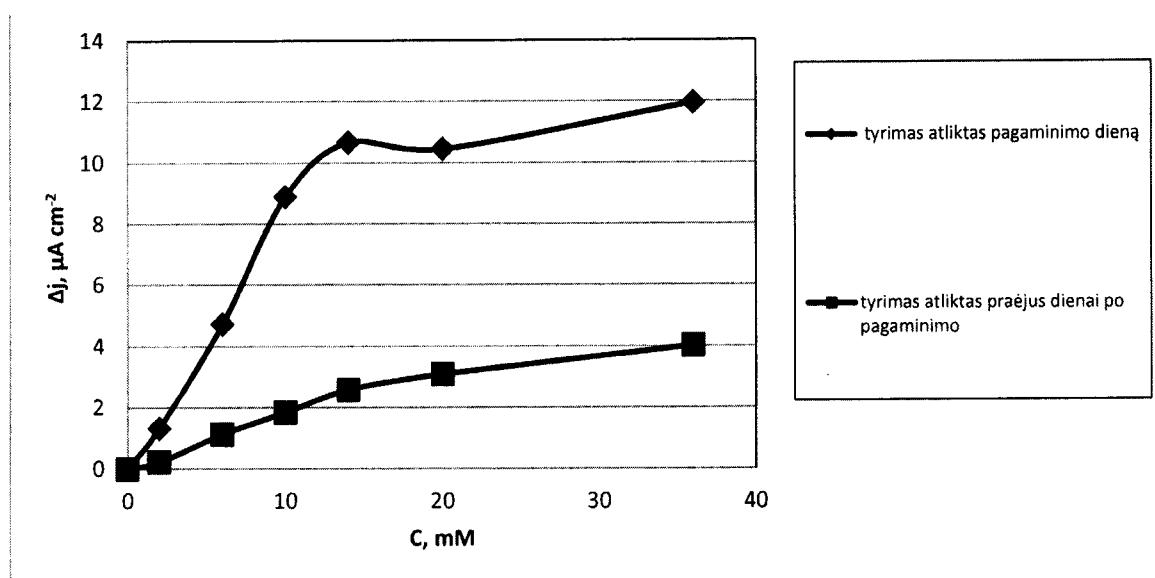


1a pav.

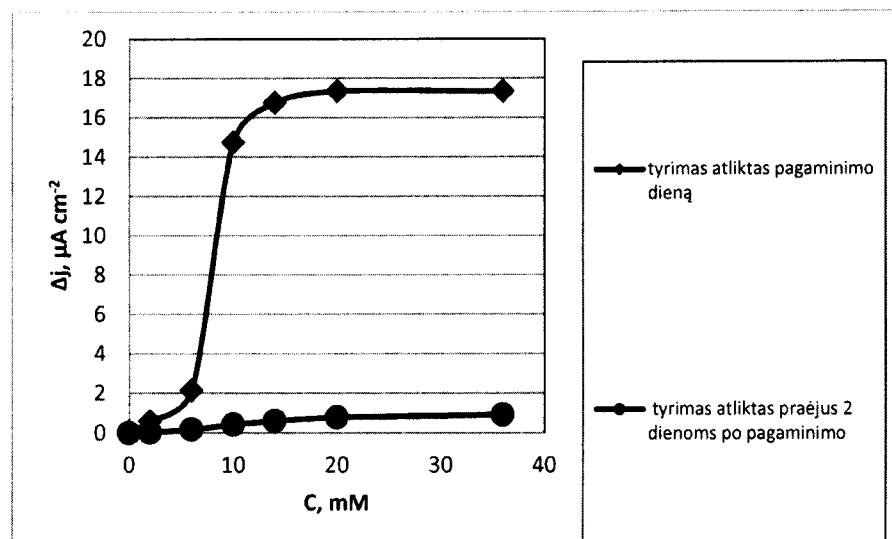


1b pav.

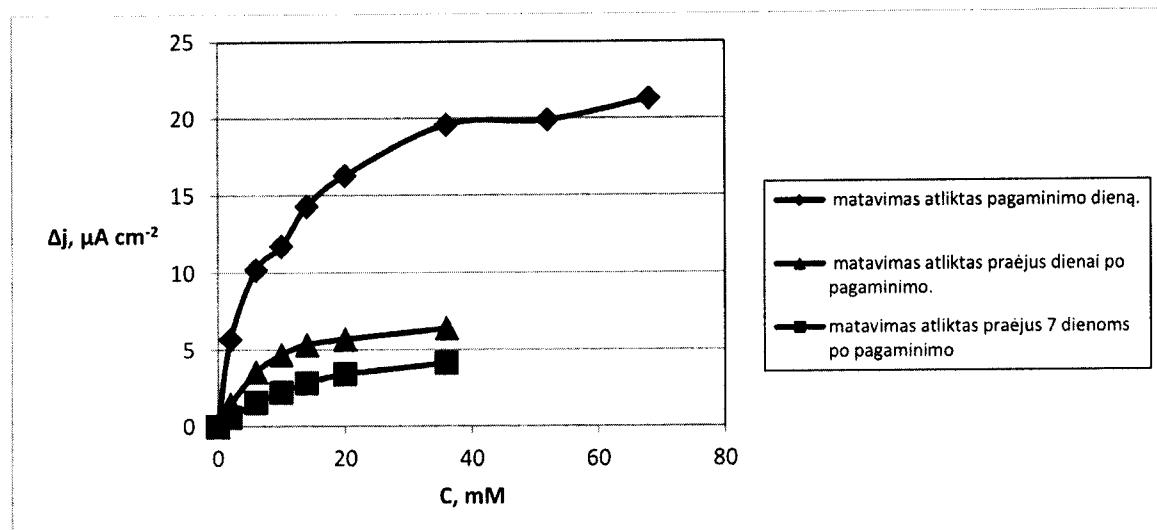


2 pav.

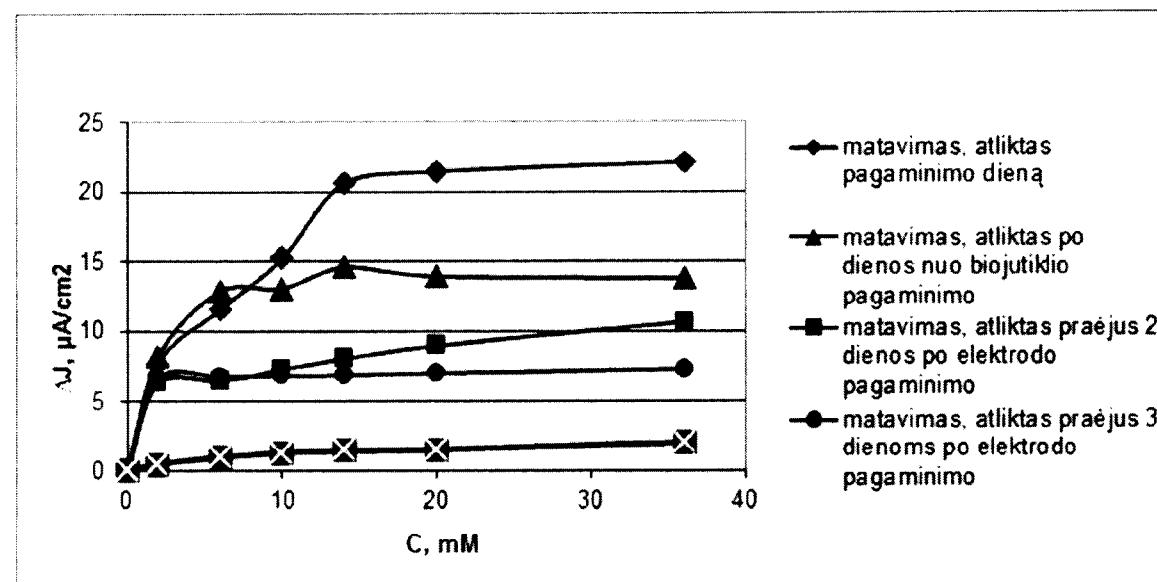


3 pav.

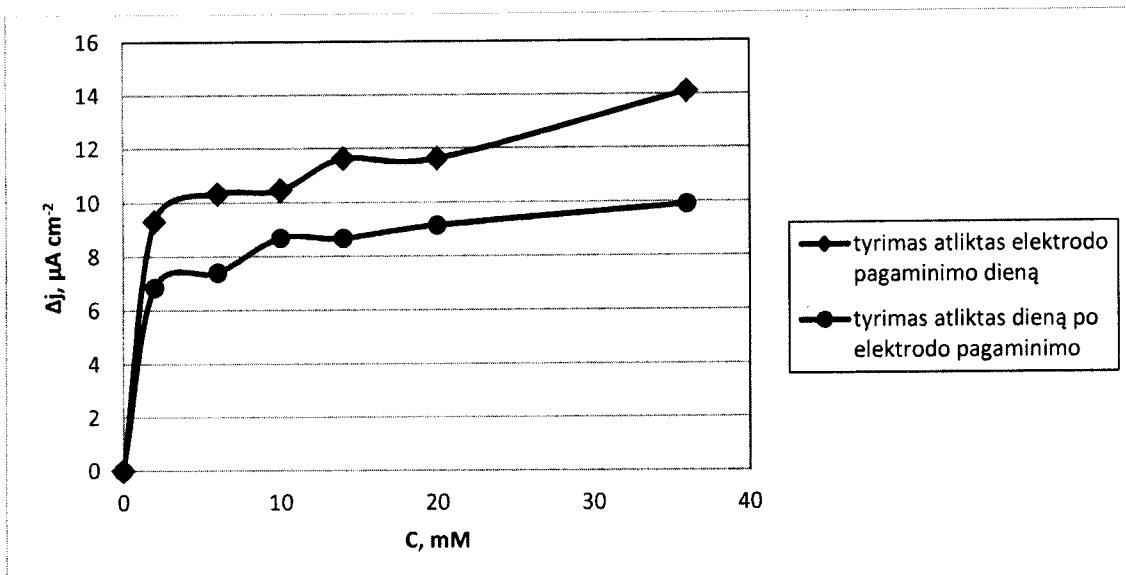


4 pav.

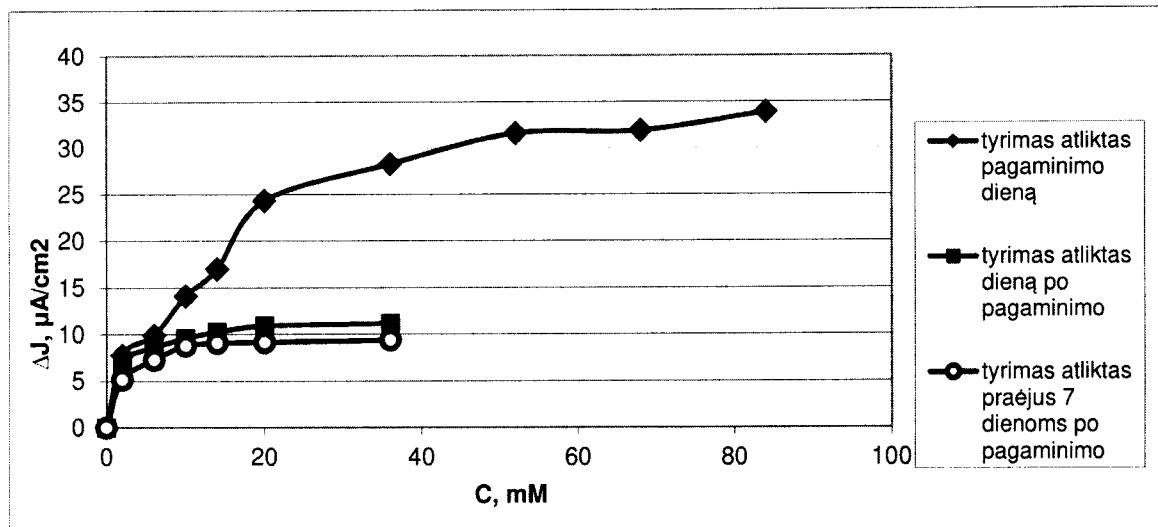


5 pav.

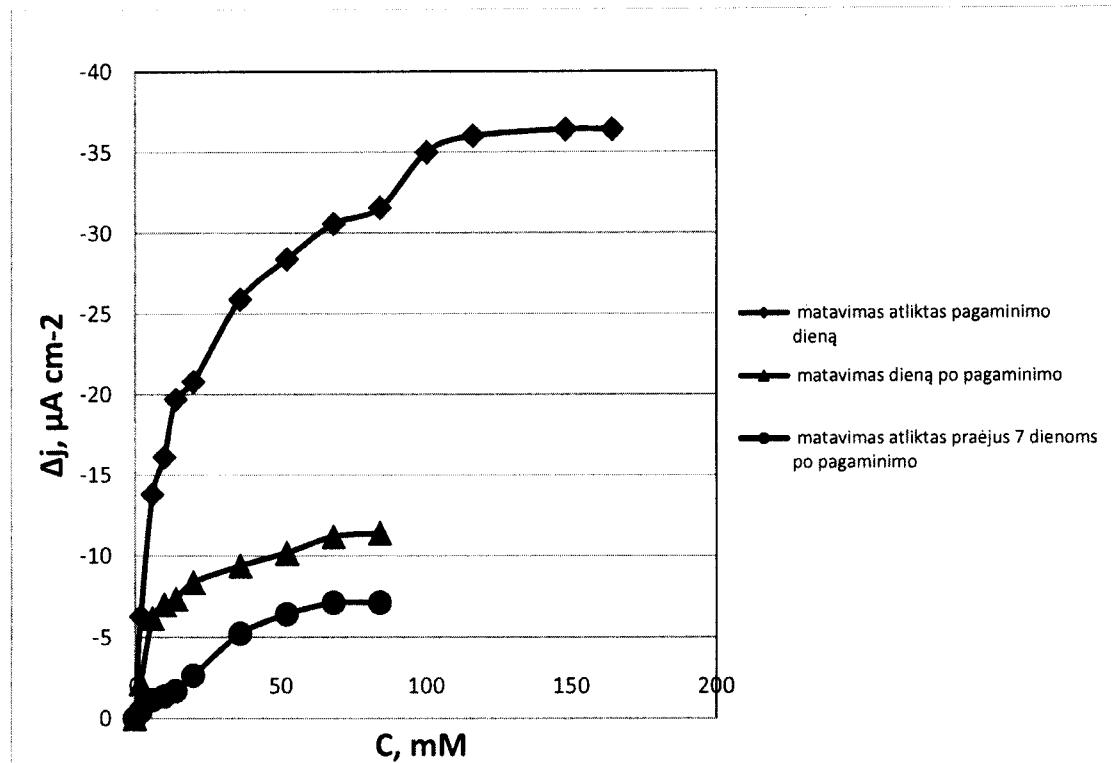

6 pav.

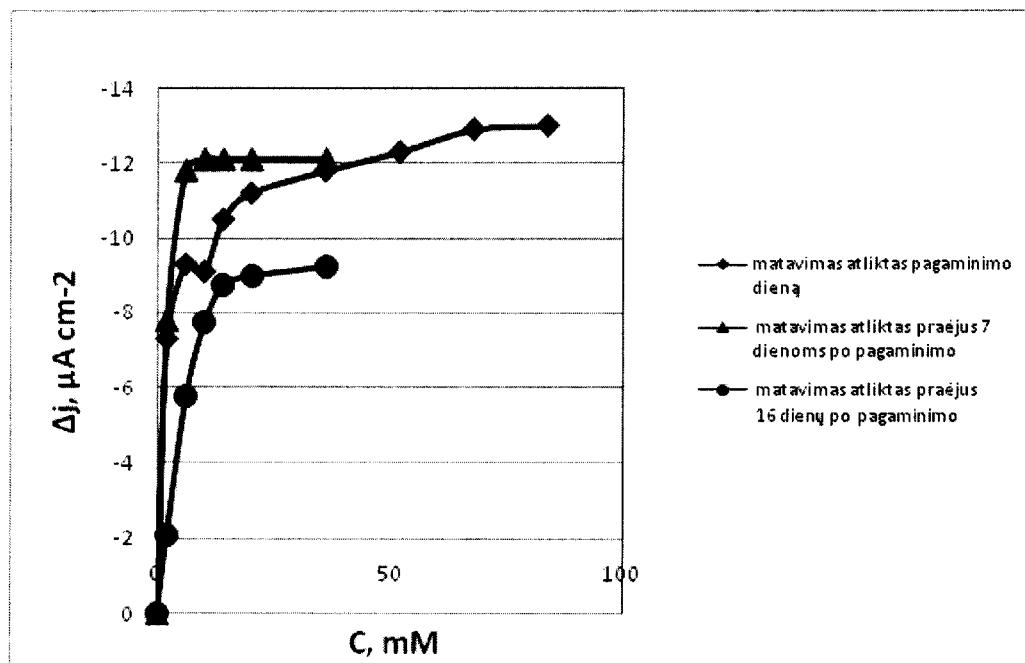

7 pav.

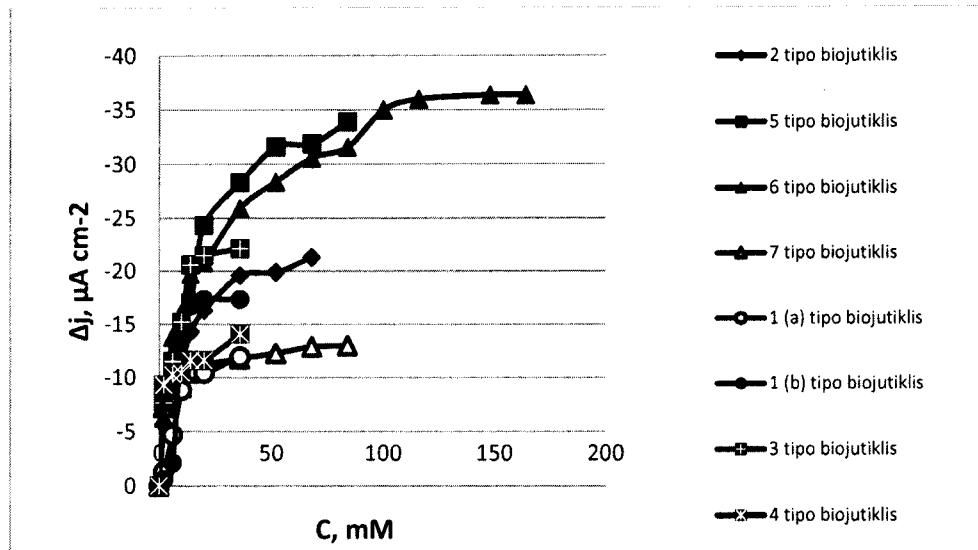

8 pav.